


Refractómetro Atago 12-30%




Refractómetro Atago 12-30%

Escala de medición 12 a 30% (contenido de agua en la miel), escala mínima de 0.1%. Tamaño y peso 4x4x17cm, 260g, termómetro con escala de compensación de temperatura. Calibración con el líquido estándar LK (RE-99010)

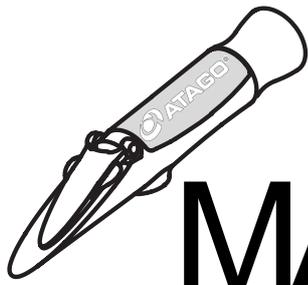


MASTER Refractómetros

Como usarlo

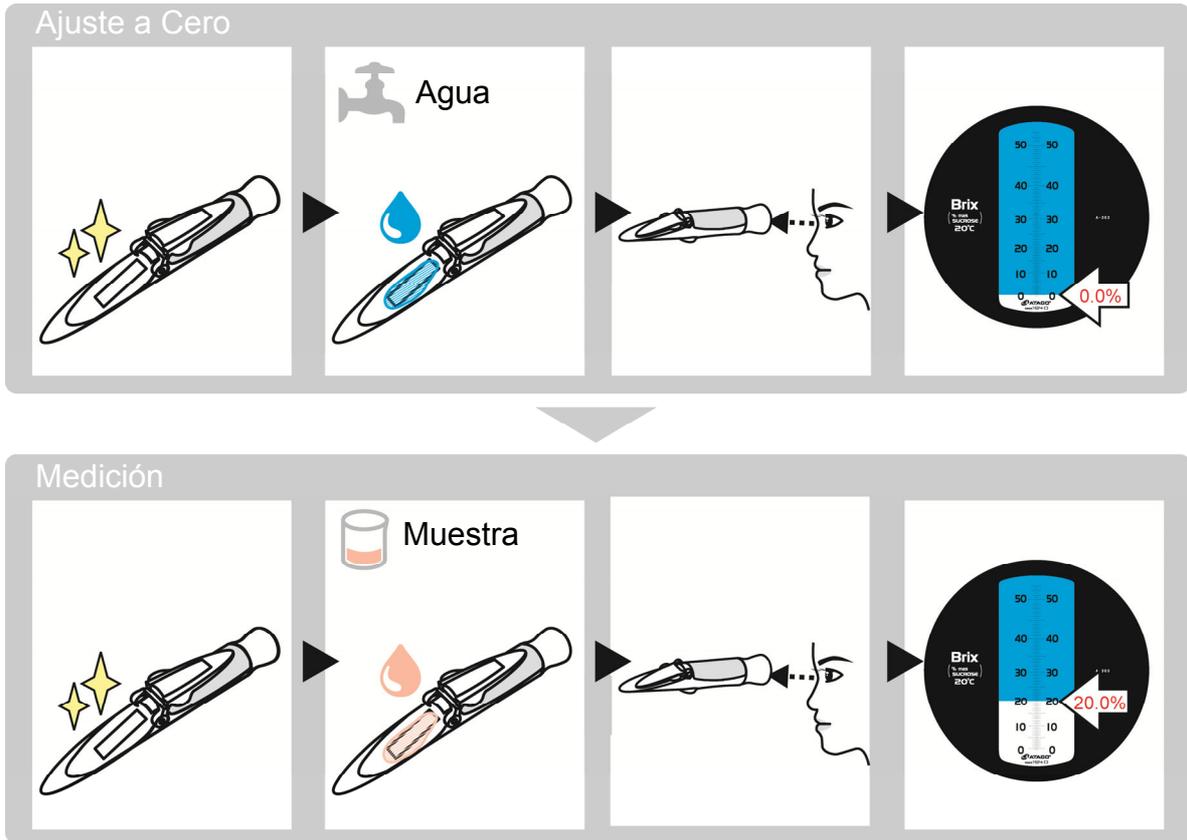


Ajuste

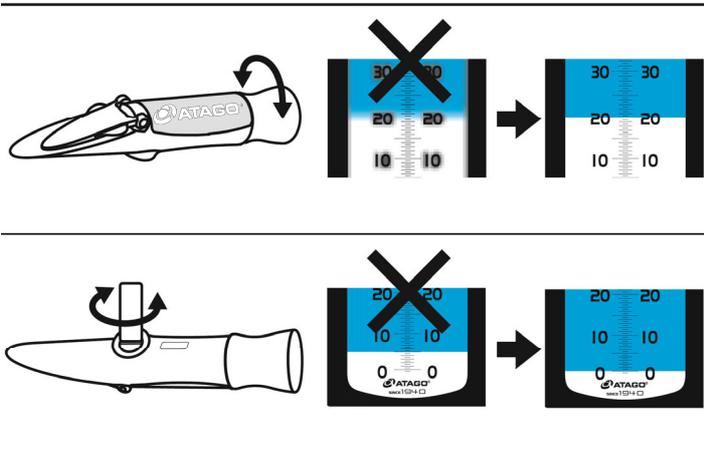

Atención

- * Es necesario lavar y secar después de su uso.
- * Limpie los residuos de aceite con alcohol o jabón.



MASTER-**M



MASTER-**α/**H